

関係者各位

2021年1月吉日

菊名記念病院

院長 村田 升

経腸栄養関連製品の ISO 規格変更に伴う対応について

厳寒の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度当院では、製品分野間の相互接続防止コネクタに係る国際規格（ISO80369-3）導入に伴い、既存規格コネクタと接続できない ISO 規格製品に規格変更いたしますので、下記及び別紙をご参照いただき、職員の皆様への周知の程、宜しくお願い申し上げます。

記

1. 新規格 ISO 製品への切替え

- (1) **2021年2月16日**から ISO 規格製品へ一斉に切り替えを行います。
- (2) コネクタ色：既存製品の黄色等から紫色へ統一変更いたします。
- (3) 接続部：既存製品(旧製品)と ISO 規格製品は直接接続できない仕様となります。

2. 既存規格製品への対応

(1) 当院から貴施設への転院

2021年2月16日以降に経腸栄養カテーテル留置処置を行った患者様は、ISO 規格製品を使用し当院より転院となります。

転院相談の際、事前にご連絡致しますので、貴施設におかれましては ISO 規格製品または「変換コネクタ」をご準備いただきます様、お願い申し上げます。

(2) 貴施設より当院への転院

当院では「変換コネクタ」を在庫しておりますので、既存製品・ISO 規格製品のいずれも対応可能です。既存製品が挿入されている患者様の場合、当院では一時的に「変換コネクタ」を使用し対応いたします。お手数ですが事前に患者様の情報お知らせ下さいます様、お願い申し上げます。

但し当院入院中にカテーテル交換を行った場合には、ISO 規格製品への変更となります。

(3) PEG 造設及び交換

PEG 造設及び交換につきましても ISO 規格製品への切り替えとなり、延長チューブの接続部分に変更となります。PEG 造設及び交換ご依頼の際は、事前に接続情報等の確認をさせていただきます。

以上

《問い合わせ先》 菊名記念病院

地域医療サービスセンター

医療安全管理室 機器担当 内線 PHS5453

電話 045-402-2211・045-402-2212

経腸栄養分野のコネクタ製品形状が変わります

製品分野間の誤接続を防止する目的で、国際的に規格（コネクタ形状）の変更が進められており、経腸栄養分野におきましてコネクタ製品形状が変更されます。（ISO80369-3）

● 菊名記念病院 変更開始時期


2021年2月16日

● 変更点


- ①コネクタ形状の変更
- ②コネクタ色の変更

(黄色) → (紫色)

現行規格

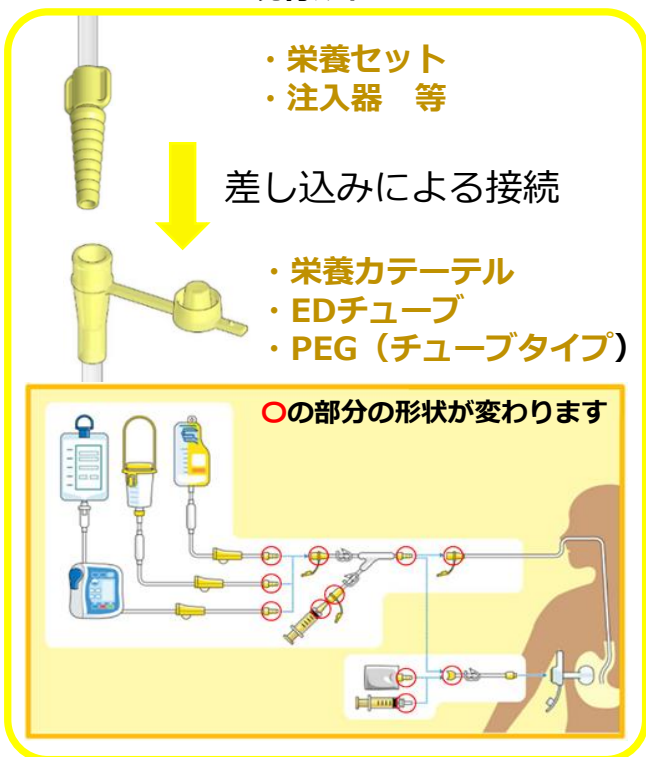

新規格

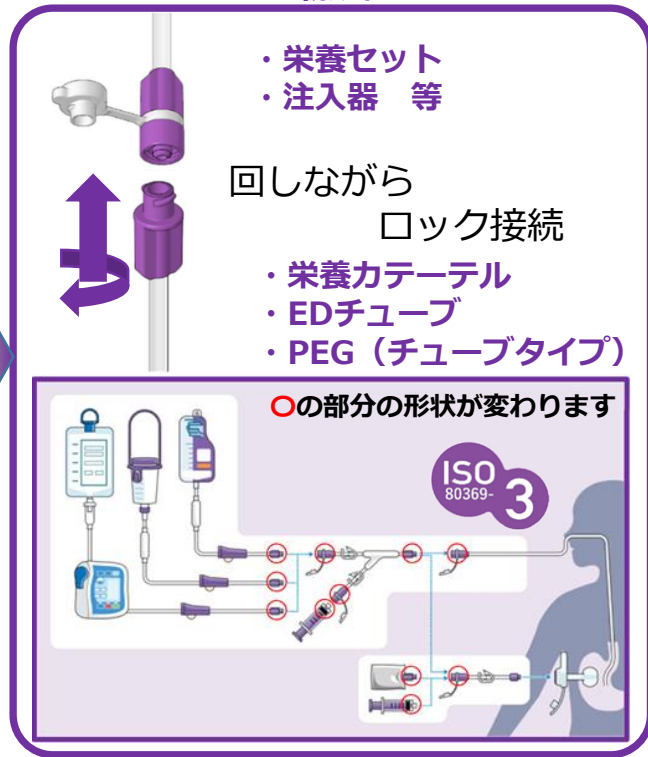

● 変更移行時期の対応について

新規格と現行規格との間では接続できなくなります。

完全切替までの期間は、新規格と現行規格を接続するための「変換コネクタ」で対応します。

